

Bestelformulier

VARILUX PHYSIO FIT
TWIN RX™ TECHNOLOGY




Essilor Nederland
Marconistraat 9
Postbus 102
6900 AC Zevenaar
Telefoon (0316) 580 580
Telefax (0316) 580 585

Datum (dd / mm / jiii)	/ /	Uw referentie	
Klantnummer		Naam bedrijf	
Glastype	Varilux Physio fit	Coating	Crizal A2
Kleur		Transitions	<input type="checkbox"/> Bruin <input type="checkbox"/> Grijs
Diameter	<input type="checkbox"/> Ø 60 / 65 <input type="checkbox"/> Ø 70 / 75 <input type="checkbox"/> Ø 65 / 70 <input type="checkbox"/> Ø 75 / 80	Materiaal	<input type="checkbox"/> Lineis 1.74 <input type="checkbox"/> Ormix 1.60 <input type="checkbox"/> Stylis 1.67 <input type="checkbox"/> Orma 1.50
Brilvoorschrift	R Sferisch <input type="text"/> Cilinder <input type="text"/> As <input type="text"/> Additie <input type="text"/> Prisma <input type="text"/> Basis <input type="text"/> L <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Fit parameters	Hoornvliesafstand <input type="text"/> mm	Inclinatiehoek (°) <input type="text"/> graden	Doorbuigingshoek (°) <input type="text"/> graden
Centreer info.	R Pupilafstand <input type="text"/> mm	Inslijphoogte <input type="text"/> mm	Montuur- / glasmaten (mm) <input type="text"/> breedte
	L <input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> hoogte
			<input type="text"/> neus
Montuurtype	<input type="checkbox"/> Randbril <input type="checkbox"/> Glasbril	Dikte bij dunste boorgat (*) <input type="text"/> mm	
	<input type="checkbox"/> Kunststof <input type="checkbox"/> Nylon	Minimale randdikte (*) <input type="text"/> mm	

(*) Wilt u de tekening ook gebruiken voor afwijkende randdikte of het aangeven van de gewenste dikte bij boorgaten?

Préal

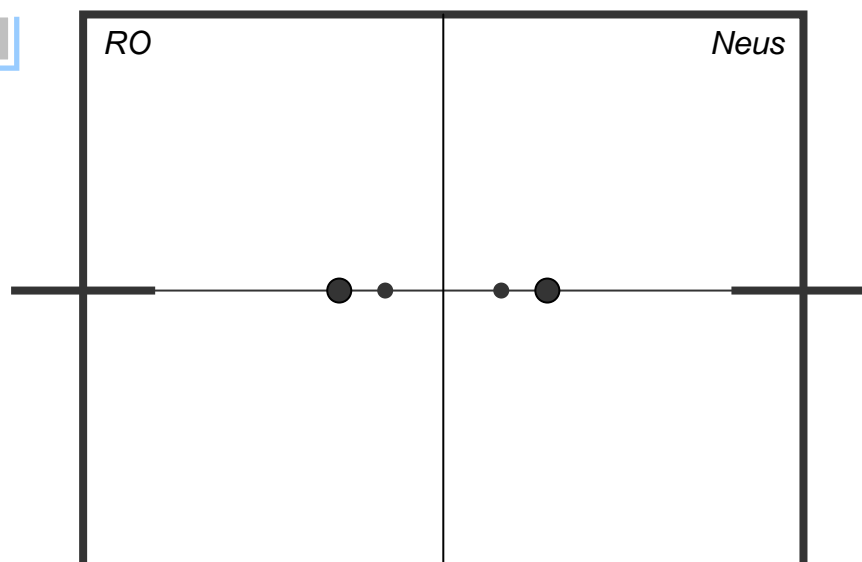

- Wilt u duidelijk de boorgaten aanduiden?
- Wilt u de glasvorm exact omlijnen met een zwarte pen?
- Wilt u met een kruisje de positie van het doorkijkpunt voor de verte aangeven?